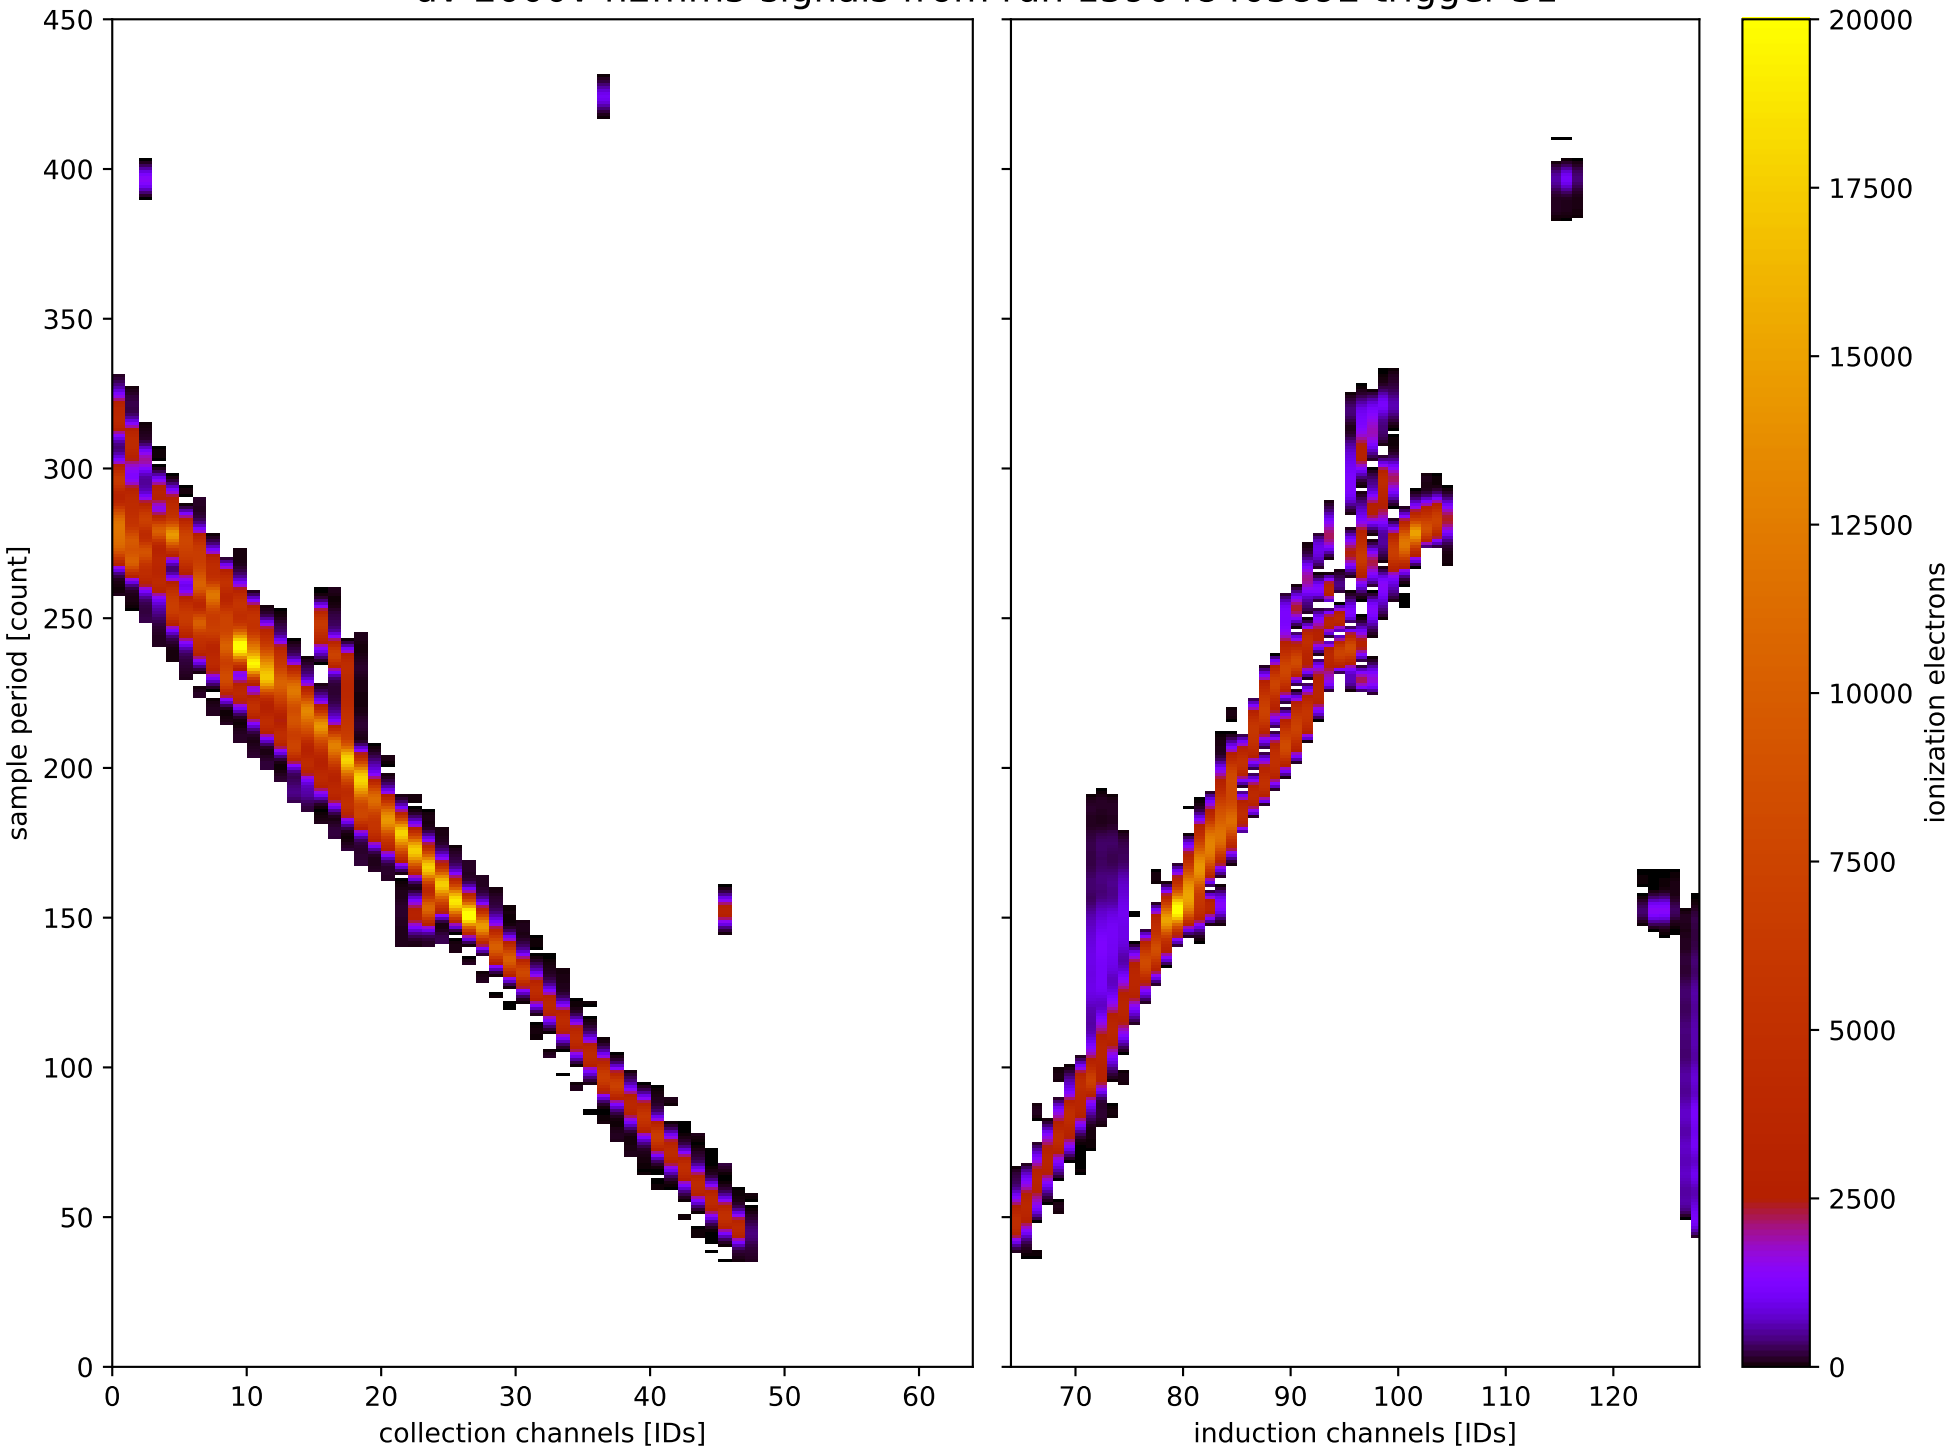

dv-2000v-h2mm5 signals from run 159048405892 trigger 31
sample period [count]
collection channels [IDs]
induction channels [IDs]
ionization electrons
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000